




A MED-EL cochleáris implantátum megbízhatósága

A MED-EL megbízhatósági jelentése megfelel az ISO 5841-2:2014 nemzetközi szabványnak ^[4] és a cochleáris implantátum meghibásodásairól és magyarázatairól szóló európai konszenzusban meghatározott elveknek. ^[5]

Mivel 2006 óta minden legújabb generációs titán implantátumunk összesített kumulatív túlélési aránya meghaladja a 99%-ot, a MED-EL a vezető a cochleáris implantátum megbízhatóságában. ^{[1][2][3]}

SYNCHRONY 2

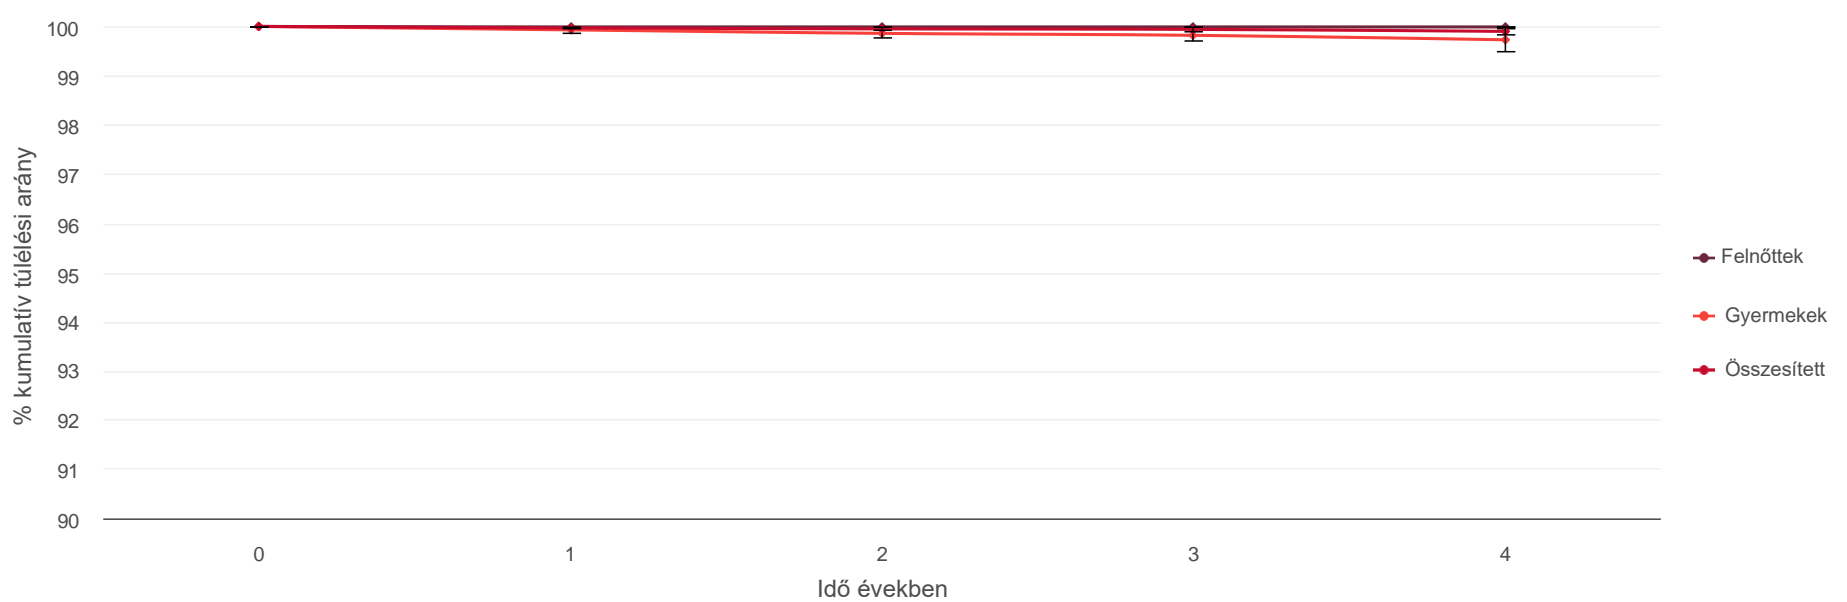




Megbízható Hangprocesszorok

A legújabb generációs hangprocesszoraink bizonyítottan kiemelkedően megbízhatóak. Valójában az összes hangprocesszorunk átlagos havi javítási aránya^[20] alacsony.^[3]

Ha egy hangprocesszor átlagos havi javítási aránya 0,32%, az azt jelenti, hogy átlagosan havonta 32 hangprocesszort küldtek vissza javításra a világban eladott 10 000 hangprocesszorból a lefedett időszak végéig.

Átlagos havi javítási arány

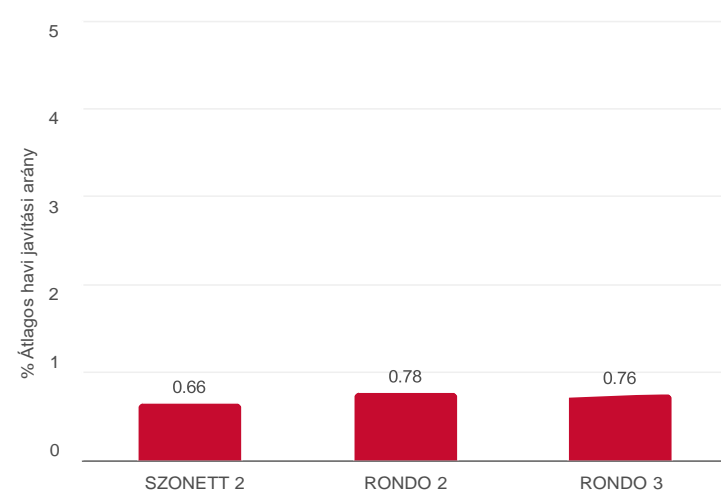

MED-EL, 2024. január 2-i adatok alapján